


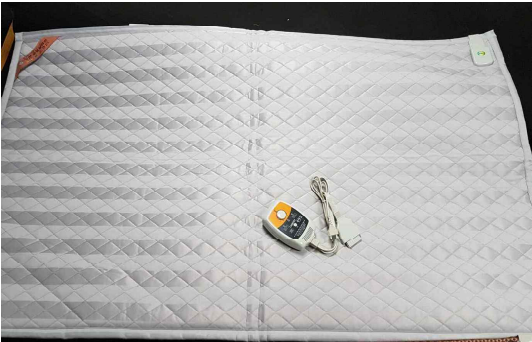


조치구분	수거 등의 명령			
리콜 제품	안전관리 대상구분	■ 안전인증 □ 안전확인 □ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준 준수 (높음 ← 위해도 → 낮음)		
	품목명	전기요	모델명	HG-A301, HG-A302, HG-B303, HG-B304
	브랜드명	-	제조구분(제조국)	대한민국
	사업자명	(주)대호플러스	인증/신고번호	HH071508-14007 (인증모델 : HG-A301, HG-A302, HG-B303, HG-B304)
	대표자명	정의광	인증/신고일자	2017.09.29
리콜 제품	< 전체 사진 >		< 부분 사진 >	
				
위해 정도	제품 결함	○(최중결함) : 온도상승 시험 부적합 - 전열소자 기준치 초과 - 기준값: 95 °C / 측정값: 98.4 °C ○(경결함) : 표시사항 부적합 - 표시사항 내용 누락 a. 모델명 다수 기재		
	위해 정보	○ 잘못된 정보 제공의 우려가 있음 ○ 신체에 장시간 접촉할 경우 화상 유발 가능		
대처 방법	소비자 행동요령	○ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것 ○ 문의처 또는 구입처 등에 연락·방문하여 새 제품으로 교환, 환불 등 조치를 받을 것		
리콜 문의	문의처	(주)대호플러스	연락처	031-535-9431

조치 구분	수거 등의 명령			
리콜 제품	안전관리 대상구분	<input checked="" type="checkbox"/> 안전인증 <input type="checkbox"/> 안전확인 <input type="checkbox"/> 공급자 적합성 확인 <input type="checkbox"/> 안전기준 준수 (높음 ← → 낮음)		
	품목명	전기매트	모델명	WT-27
	브랜드명	-	제조구분(제조국)	대한민국
	사업자명	(주)원테크	인증/신고번호	HH071450-18007A (인증모델 : WT-27)
	대표자명	채수량	인증/신고일자	2018.09.13
	< 전체 사진 >		< 부분 사진 >	
				
위해 정도	제품 결함	<ul style="list-style-type: none"> ○(최종결함) : 온도상승 부적합 - 전열소자 온도 기준치 초과 - 기준값: 95 °C (정상상태) / 측정값: 120.3 °C 		
	위해 정보	○신체에 장시간 접촉할 경우 화상 유발 가능		
대처 방법	소비자 행동요령	<ul style="list-style-type: none"> ○해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것 ○문의처 또는 구입처 등에 연락·방문하여 새 제품으로 교환, 환불 등 조치를 받을 것 		
리콜 문의	문의처	(주)원테크	연락처	070-4324-0218

조치 구분	수거 등의 명령			
리콜 제품	안전관리 대상구분	<input checked="" type="checkbox"/> 안전인증 <input type="checkbox"/> 안전확인 <input type="checkbox"/> 공급자 적합성 확인 <input type="checkbox"/> 안전기준 준수 (높음 ← 위해도 → 낮음)		
	품목명	전기매트	모델명	KLB-300
	브랜드명	-	제조구분(제조국)	대한민국
	사업자명	대상의료기	인증/신고번호	HH071179-13014B (인증모델 : KLB-300)
	대표자명	양민우	인증/신고일자	2018.01.12
	< 전체 사진 >		< 부분 사진 >	
				
위해 정도	제품 결함	<p>○(최중결함) : 온도상승 시험 부적합</p> <ul style="list-style-type: none"> - 전열소자 온도 기준치 초과 - 기준값: 95 ℃ (정상상태) / 측정값: 130 ℃ <p>○(경결함)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 표시사항 부적합 <ul style="list-style-type: none"> - 표시사항 누락 <ol style="list-style-type: none"> a. KC마크, 제조국, 2종기기 마크, 제조년월 누락 2. 입력 및 전류 부적합 <ul style="list-style-type: none"> - 표시: 50 W, 측정: 60 W - 오차: +20 % / 허용 오차: -20 % ~ +10 % 		
	위해 정보	<p>○잘못된 정보제공의 우려가 있음</p> <p>○신체에 장시간 접촉할 경우 화상 유발 가능</p>		
대처 방법	소비자 행동요령	<p>○해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것</p> <p>○문의처 또는 구입처 등에 연락·방문하여 새 제품으로 교환, 환불 등 조치를 받을 것</p>		
리콜 문의	문의처	대상의료기	연락처	031-544-7535

조치 구분	수거 등의 명령			
리콜 제품	안전관리 대상구분	<input checked="" type="checkbox"/> 안전인증 <input type="checkbox"/> 안전확인 <input type="checkbox"/> 공급자 적합성 확인 <input type="checkbox"/> 안전기준 준수 (높음 ← 위해도 → 낮음)		
	품목명	전기찜질기	모델명	DE-01
	브랜드명	-	제조구분(제조국)	대한민국
	사업자명	(주)프로텍메디칼	인증/신고번호	HD07224-19018 (인증모델 : DE-01)
	대표자명	김남성	인증/신고일자	2019.02.12
		< 전체 사진 >		< 부분 사진 >
				
위해 정도	제품 결함	<ul style="list-style-type: none"> ○(최중결함) : 온도상승 시험 부적합 <ul style="list-style-type: none"> - 발열체 온도 기준치 초과 - 기준값: 140 °C / 측정값: 161.8 °C ○(경결함) : 표시사항 부적합 <ul style="list-style-type: none"> - 사용설명서 누락 		
	위해 정보	○신체에 장시간 접촉할 경우 화상 유발 가능		
대처 방법	소비자 행동요령	<ul style="list-style-type: none"> ○해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것 ○문의처 또는 구입처 등에 연락·방문하여 새 제품으로 교환, 환불 등 조치를 받을 것 		
리콜 문의	문의처	(주)프로텍메디칼	연락처	1544-4893 032-507-1130